


WME Form 3F

Widerstandsthermometer mit Flanschschutzrohr, Schutzrohr aus nahtlosem Rohr, an der Spitze verjüngt für einen schnelleren Wärmeübergang Schutzrohr nach DIN 43772.

Resistance thermometer, Flange thermowell made from seamless pipe material with stepped tip for a fast response time. Thermowell acc. DIN 43772.

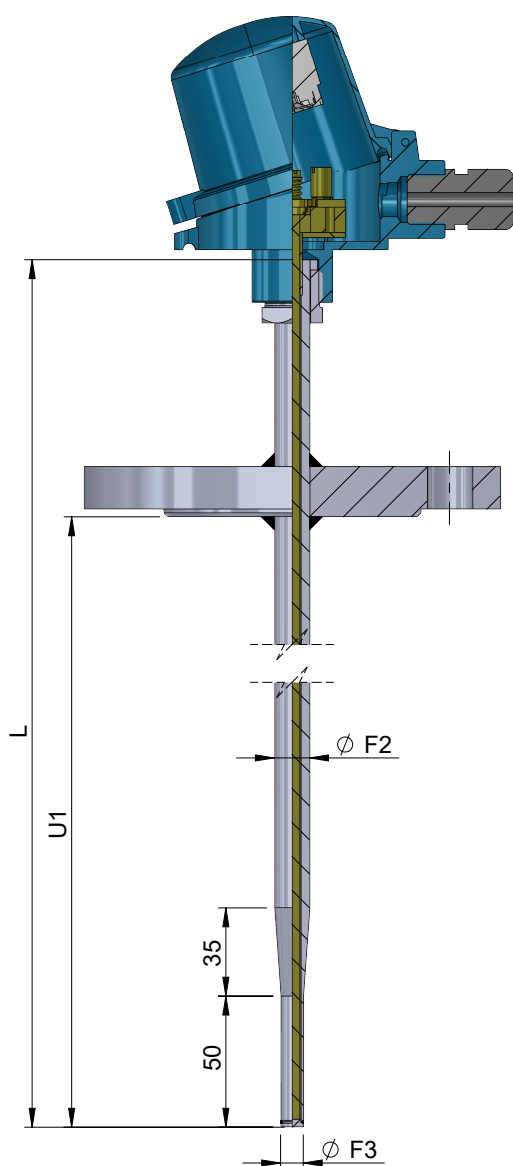

Messeinsatz - Anschlussart Measuring insert - Connection				
Keramischer Anschlussblock Ceramic terminal		1	01	
Flexible Anschlussdrähte flexible connection wires		2		
Montierter Messumformer mounted transmitter		3		
Messeinsatz - Messwiderstand / Measuring insert - Detector				
1 x Pt100		1	02	
2 x Pt100		2		
Messeinsatz - Schaltungsart / Measuring insert - circuit type				
2-Leiter 2-wire		1	03	
3-Leiter 3-wire		2		
4-Leiter 4-wire		3		
Messeinsatz - Toleranzklasse / Measuring insert - Accuracy				
Klasse A class A -70...+400°C		1	04	
Klasse A class A -200...+600°C		2		
Klasse AA class AA (1/3B) -200...+600°C		3		
Andere (bitte angeben) Different (please specify) (1/5B 1/10B ...)		C		
Anschlusskopf / Connection head				
BUZ (Al)		1	05	
BUZH (Al)		2		
BUS (Al)		3		
BUSH (Al)		4		
XI-DSN (PAV - PA12)		5		
XI-DSNW (PAV - PA12)		6		
Andere Different [BBK,BBKH (PA),BV (SS)]		C		
Länge L Length L		Länge U1 Length U1		
305 mm		225 mm	1	06
395 mm		315 mm	2	
545 mm		465 mm	3	
_____ mm (U1 + min. 60 mm)		_____ mm	C	
Schutzrohr Thermowell Ø F2		Ø F3		
Ø 9 x 1 mm		Ø 6 mm	1	07
Ø 11 x 2 mm		Ø 6 mm	2	
Ø 12 x 2,5 mm		Ø 9 mm	3	
Ø 14 x 2,5 mm		Ø 11 mm	4	
Andere Ausführung (bitte angeben) other version (please specify)		C		
Flansch Flange				
DN25/PN40 B1 DIN EN 1092-1		1	08	
DN40/PN40 B1 DIN EN 1092-1		2		
DN50/PN16 B1 DIN EN 1092-1		3		
DN50/PN40 B1 DIN EN 1092-1		4		
Andere Ausführung (bitte angeben) other version (please specify)		C		
Werkstoff Material				
1.4571 ASTM A182 Grade F316Ti		1	09	
1.4404 ASTM A182 Grade F316L		2		
1.4539 ASTM A1182 Grade TP 904L		3		
anderer Wst. (siehe Liste) different Mat. (please refer material list)		C		
Beschichtung Coating				
ECTFE (Halar)		1	10	
PFA		2		
Tantal Tantalum (sleeve)		3		
Andere Ausführung (bitte angeben) other version (please specify)		C		
Dokumentation Documentation				
Materialprüfzeugnis Material certificate 3.1 - EN 10204		1	11	
Kalibrierung (Punkte angeben) Calibration (please specify)		2		
Schutzrohrberechnung Strength calculation (DIN / ASME)		3		
Ohne / none		K		
Explosionsschutz Explosion protection				
⚠ II 1/2 G Ex ib IIC T1...T6 Ga/Gb		1	12	
⚠ II 1/2 D Ex tb IIIC T440°C...T63°C Da/Db		2		
Ohne / none		K		

W32.